

## Анализатор температуры точки росы по углеводородам, модель 241CE II



### Назначение

Анализатор АМЕТЕК 241CE II предназначен для определения точки росы по углеводородам в природном газе в процессе его добычи, переработки, транспортировки и потребления.

Анализатор 241CE II допущен для автономной работы во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой 1ExdII BT4 X.

### Особенности

- ♦ Высокая чувствительность и точность
- ♦ Нечувствительность к помехам
- ♦ Большой ресурс измерительной ячейки
- ♦ Простая проверка с использованием чистого пропана
- ♦ Постоянная диагностика


### Описание

Работа анализатора основана на первичном принципе – конденсации углеводородов на охлаждаемом зеркале. Для циклического охлаждения и нагрева зеркала применяется трехступенчатый термо-электрический охладитель/нагреватель (элемент Пельтье).

Поверхность зеркала освещается источником постоянной интенсивности. Детектирование момента конденсации осуществляется оптической системой, которая регистрирует изменение интенсивности отраженного света от поверхности охлаждаемого зеркала.

Температура зеркала определяется с помощью платинового термометра сопротивления. Процессом измерения и обработкой результатов управляет встроенный микропроцессор, который также выполняет повторяющиеся измерительные циклы, состоящие из трех этапов: продувки, охлаждения и нагрева. При охлаждении и нагреве ячейки выход пробы запирается соленоидным клапаном.

Диагностическая программа непрерывно контролирует ключевые рабочие параметры и ход каждого этапа измерительного цикла.

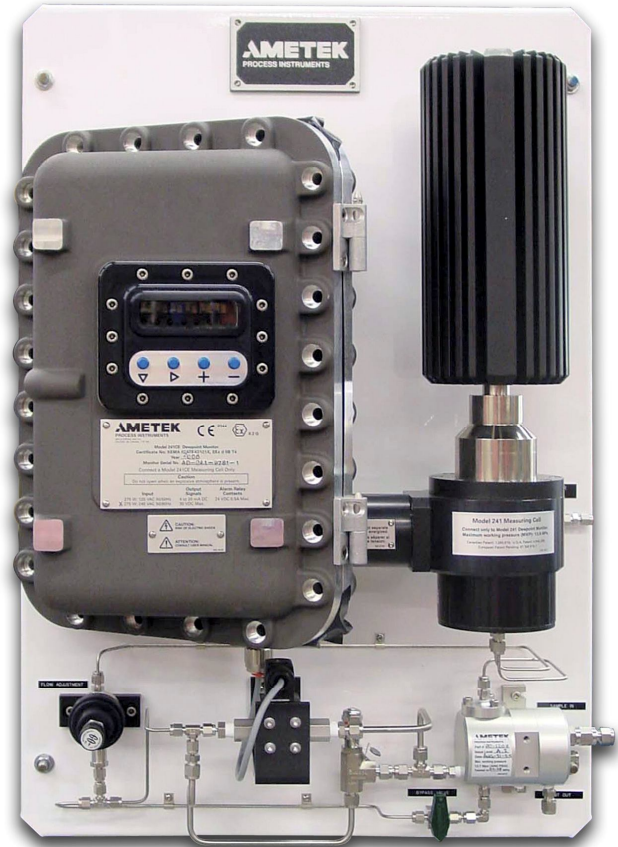

На встроенный дисплей кроме значения точки росы по углеводородам выводится информация о последнем значении измеренной температуры точки росы, рабочем давлении внутри измерительной ячейки (при наличии датчика), продолжительности работы монитора, диагностика состояния работы монитора и другая служебная информация. Имеются токовые выходы 4-20 мА для непрерывной регистрации измеренной точки росы и условного кода состояния.

Высокая точность при измерении температуры точки росы сочетается с высокой надежностью при флуктуационных изменениях рабочего давления, температуры, расхода газа. Специальный фильтр на входе предохраняет анализатор от возможного загрязнения такими типовыми продуктами, как аэрозоли, механические частицы, жидкости.

# Анализатор температуры точки росы по углеводородам, модель 241CE II

## Технические характеристики

Диапазон	от $T_{окр} - 60^{\circ}\text{C}$ до $T_{окр} - 5^{\circ}\text{C}$ , но не ниже $-40^{\circ}\text{C}$
Единицы измерения	$^{\circ}\text{C}$ точки росы
Погрешность	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Продолжительность измерительного цикла	15...45 мин (устанавливается пользователем)
Сигнализация	6 реле (=24 В, 0,5 А), 7 светодиодов на дисплее
Аналоговые выходы (2 канала)	4...20 мА: температура точки росы ( $-40...+40^{\circ}\text{C}$ ), код состояния (питание =15...30 В обеспечивается пользователем)
Интерфейс	RS232, RS485/Modbus
Дисплей	12-разрядный алфавитно-цифровой, 1 строка, прокрутка автоматическая
Клавиатура	Мембранная, 4 клавиши
Параметры пробы на входе	Давление: 13,79 МПа (макс.) Температура: 0...40 $^{\circ}\text{C}$ Расход: 1...5 нл/мин в режиме продувки, 0.3...3,3 нл/мин в режиме измерения
Питание	220/240 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц, не более 275 Вт
Взрывозащита	1ExdIIIBT4 X
Окружающая среда	10...40 $^{\circ}\text{C}$ , 0...90% относит. влажности без конденсации
Габариты (Ш x В x Д)	838x572x289 мм (навесной монтаж на панели)
Масса нетто	45 кг

## Информация для заказа

### Стандартная поставка:

- ◆ Анализатор 241CE II, смонтированный на панели с газовой схемой
- ◆ Инструкции по монтажу, пуску, эксплуатации и обслуживанию на русском языке
- ◆ Методика поверки

### По дополнительному заказу:

- ◆ Блок фильтров для пробы
- ◆ Датчик давления для пробы
- ◆ Шкаф для 241 с электроподогревом (2ExdellCT4), 500 Вт, 1100x1100x500 мм

**Примечание:** Имеются поточные анализаторы влажности природного газа (по воде): модели **5000** и **5812**, принцип действия которых основан на изменении частоты колебания кристалла кварца, покрытого влагопоглощающим полимером.

Анализатор **5000** состоит из двух частей: полевого блока **560В**, который устанавливается в непосредственной близости от места отбора пробы или в необслуживаемой анализаторной, и контроллера **5000**, который устанавливается на щите в операторной. Максимальная длина специального кабеля между полевым блоком и контроллером - 600 м. Контроллер 5000 позволяет реализовать многотборный вариант (до 4).

Анализатор **5812** (только одноточечный вариант) конструктивно выполнен в одном корпусе и может быть установлен как в анализаторской, так и в специальном погодозащищенном и обогреваемом шкафу системы пробоподготовки **561**.